

Muestra de los mantenimientos realizados **Junio 2024**

Mantenimiento preventivo, máquina de rayos x.




Mantenimiento preventivo, monitor de ritmo cardíaco.



17 jun. 2024 7:56:51

Padre Las Casas Padre las Casas Azua


Mantenimiento correctivo, lámparas led.

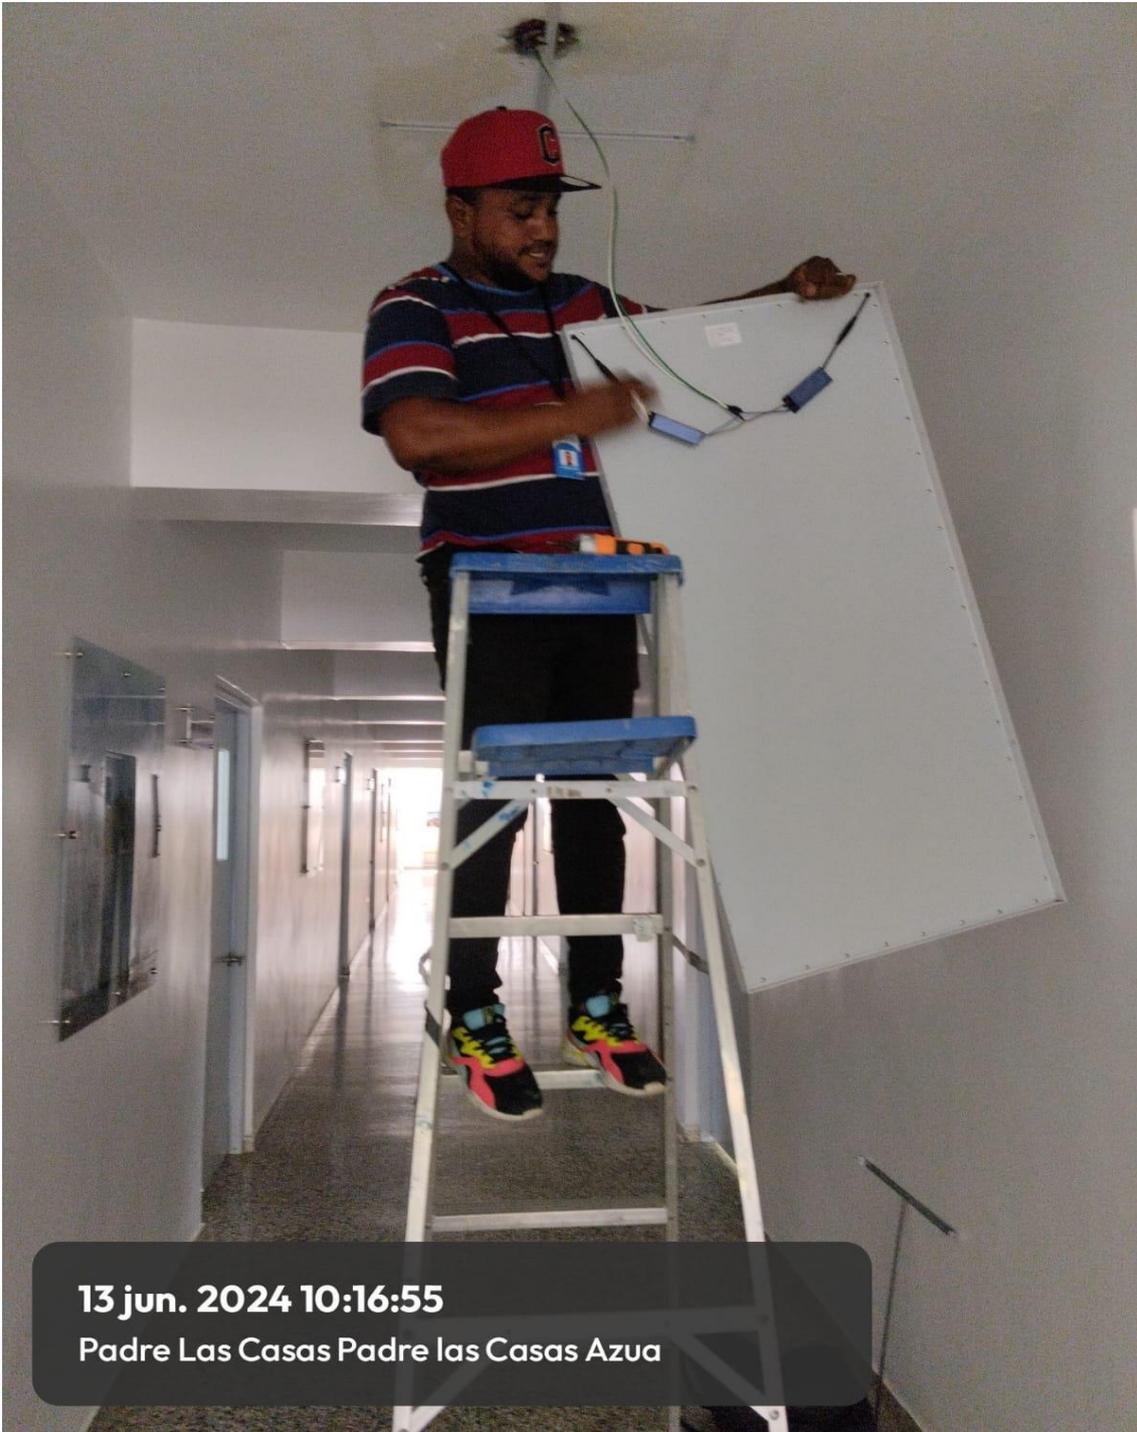

13 jun. 2024 10:16:55

Padre Las Casas Padre las Casas Azua

Mantenimiento preventivo, camilla ginecológica.

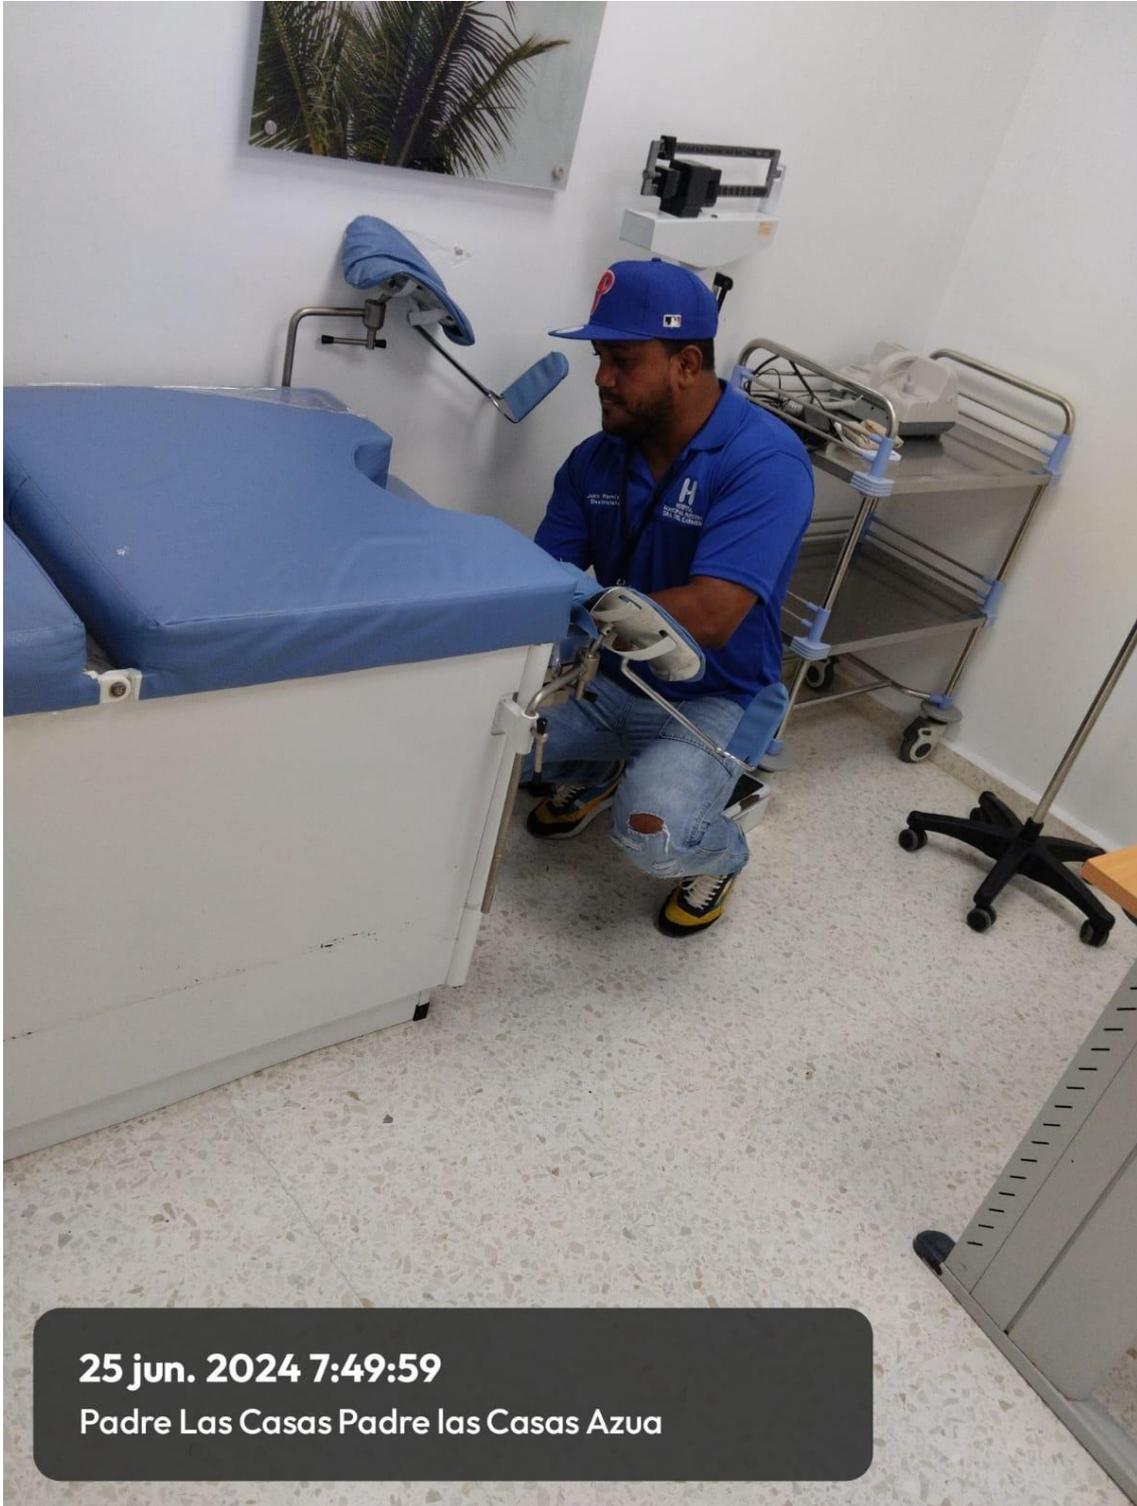

25 jun. 2024 7:49:59

Padre Las Casas Padre las Casas Azua

Mantenimiento preventivo, incubadora neonatal.



INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	24/06/24
NOMBRE DEL RESPONSABLE	VI-El Valle Jairo Ramírez	PROVINCIA	AZUA
		AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	maquina de hacer x	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input checked="" type="checkbox"/> Usado	Reparado	
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

maquina de hacer x
chequeo de todos los cables
revisión de todas las tuercas
mantenimiento en general

OBSERVACIONES


FIRMA RESPONSABLE



INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	17/06/24
NOMBRE DEL RESPONSABLE	VI-El Valle	PROVINCIA	AZUA
	Jairo Ramirez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO


INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	Monitor de ritmo	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE	cardisco	NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/>	Reparado	
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Monitor de ritmo Cardíaco;
prueba de Funcionamiento
por el externo
todo en buen estado

OBSERVACIONES


FIRMA RESPONSABLE



INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	13/06/2024
NOMBRE DEL RESPONSABLE	VI-El Valle	PROVINCIA	AZUA
	Jairo Ramirez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	Lampara led	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/>	Reparado	
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

B explosion de lampara led.
cambio de lamparas dañada por muestra en taller #8

OBSERVACIONES

Jairo Ramirez
FIRMA RESPONSABLE



INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	25/06/20
NOMBRE DEL RESPONSABLE	VI-El Valle	PROVINCIA	AZUA
	Jairo Ramírez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO


INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	Camilla gimnástica	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input checked="" type="checkbox"/> Usado	Reparado	
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Camilla gimnástica
Cheques de todas
sus partes
de suspensión y amortiguador

OBSERVACIONES


FIRMA RESPONSABLE



INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	22/06/21
NOMBRE DEL RESPONSABLE	VI-El Valle	PROVINCIA	AZUA
	Jairo Ramirez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	En tubadara	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/>	Reparado	
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

En tubadara:
prueba de funcionamiento
chequeo de los cables
mantenimiento general

OBSERVACIONES


FIRMA RESPONSABLE



MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

(Fecha: Junio-2024.)

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Ultimo Proximo		Jun	Observaciones
					Mantenimiento	Mantenimiento		
Monitores LCD de 12 pulgada, Total 33	Parte externa y cables electricos	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	8/12/2023	8/3/2024	X	Todos estan en perfecta condiciones.
CPU en Total 33	Parte externa y baterias	Limpieza y mantenimiento general, prueba de baterias y prueba de funcionamiento.	Preventivo.	Semestral	8/12/2023	8/3/2024	X	Todos estan en perfecta condiciones.
UPS Industrial en consultorios total 02	Parte externa y baterias	Limpieza general, prueba de baterias y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	11/12/2023	11/6/2024	X	Todos estan en perfecta condiciones.
Impresora Multifuncional en total 10	Parte externa, cartuchos, parte electrica.	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctricos y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	7/12/2023	7/3/2024	X	Todos estan en perfecta condiciones.
UPS 500 VA en total 29	Parte externa, baterias y conexiones electrica	Limpieza general, prueba de baterias, chequeo de partes electricas y prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	11/12/2023	11/3/2024	X	Todos estan bien excepto uno que tiene la bacteria dañada
Abanico de pared (02)	Parte Interna y externa	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Todos estan en perfecta condiciones.
Abanico pedestal en total 02	Parte Interna y externa	Limpieza general, engrase, verificación electrica, y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Todos estan en perfecta condiciones.
Abanico de techos en total 05	Parte Interna y externa	Limpieza general, engrase, verificación electrica, y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	05/0.3/2024	X	Todos estan en perfecta condiciones.
Aires acondicionados de 12 mil btu, 18 mil btu y 36 mil btu, en total 48.	Filtros del ventilador y mantenimiento general.	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	13/12/2023	13/6/2024	X	Todos estan nueno en uso, solo un aire central que se le quemo la tarjeta,
Aspirador quirurjico en total 04 unidades	Parte externa	Revisión general, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Estan bueno en uso.
Bebederos en total 03 unidades	parte externa	verificación del funcionamiento de las llave, verificación de parte eléctrica, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	4/12/2023	4/6/2024	X	Estan bueno en uso.
Bomba de agua 01 unidad	Chequeo general	Prueba de funcionamiento, verificación del CK, verificación de la parte electrica.	Preventivo	Semestral	13/12/2023	13/6/2024	X	Esta buena en uso.
Camilla Ginecologica 01 unidad	Parte externa	Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas.	Preventivo	Anual	5/12/2023	5/12/2024		Buena en uso
Carro de parro	Parte interna e externa	Verificación general, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Mensual	4/12/2023	04/1/01/2024	X	Bueno en uso
Rotador	Parte interna y externa	Mantenimiento general, verificación de los controles de velocidad y verificación de la parte mecanica.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Bueno en uso
Equipo de quimica	Parte interna y externa	Mantenimiento general, Prueba de funcionamiento, chequeo, sistema óptico, chequeo filtros, chequeo lámpara, halógena.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Bueno en uso
Maquina de hemograma	Parte interna y externa	Mantenimiento general, comprobación de (startus), calibración, lubricación de motor de jeringa y limpieza del sensor de jeringa Cojida de muestras.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Bueno en uso

Centrifuga, 01 unida	Parte interna y externa	Mantenimiento general, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Bueno en uso
Centrifuga de 32 tubo (01)	Parte interna y externa	Mantenimiento general, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso y calibración.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Bueno en uso
Compresor de Aire 01 unidad	Parte interna e externa	Calibración de presión, chequeo fuga deaire, calibración apagado y encendido automático.	Preventivo	Trimestral	14/12/2023	14/3/2024	X	Bueno en uso
Desfibrilador en total 03 unidades.	Parte interna y externa	Verificación de paletas, Limpieza e inspección de paletas, Inspección de panel frontal, chuuqueo de la fuente de alimentación, ajuste, verificación de desfibrilación sincrónica, revisión kit baterías, Prueba del cable eléctrico, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	12/12/2023	12/3/2024	X	Bueno en uso
Elestrobisturi 01 unidad	Parte externa	Limpieza general, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	12/12/2023	12/3/2024	X	Bueno en uso
Electrocardiografo en total 04 unidades	Parte externa	Mantenimiento general, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	12/12/2023	12/3/2024	X	Bueno en uso
Electrocauterio 02 unidades	Cable electrico y conexiones	Verificacion de los cable electrico y de los conectores.	Preventivo	Trimestral	12/12/2023	12/3/2024	X	Bueno en uso
Equipo de Rayos x (01)	Parte electrica, parte mecanica y maquina reveladora	Chequeo del interruptor general de la reveladora poniéndose en posición "OFF", Quitar la tapa y los paneles laterales de la reveladora, chequeo del interruptor de disparo, verificación línea de tensión, limpieza general y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Bueno en uso
Esfipmomanometro de pared (07)	Parte externa.	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	14/12/2023	14/1/2024	X	En la actualidad hay que cam biar tres efimos
Esfipmomanometro pedestal (03)	Parte externa.	Cheque general, verificacion de perila, brazaletes y tubo de conexión.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	12/12/2023	13/1/2024	X	Bueno en uso
Horno esterilizador mediano, 01 unidad	parte externa	Cheque de conexiones eletrica, limpieza general.	preventivo	Trimestral	No se le ha dado mantenimiento	3/3/2024	X	El equipo aun no esta funcionando
Estufa Industrial, 02 unidades	Tuverias, horno, hornillas.	Verificacion de las tuverias del gas, limpiezas de las hornillas, chequeo del horno y limpieza general.	preventivo	Trimestral	3/11/2023	3/002/2024		Bueno en uso
er exhibidor parado, marca Farco, 01 unid	Parte interna y externa	Mantenimiento general, verificacion electrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	13/12/2023	13/6/2024	X	Bueno en uso
Frizer acostado Farco 01 unidad	Parte interna y externa	Mantenimiento general, verificacion electrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	13/12/2023	13/6/2024	X	Bueno en uso
Horno esterilizador 02 unidades	Parte externa	Limpieza general, verificación de voltaje, verificación de temperatura y prueba del equipo.	Preventivo	Semestral	No se le ha dado mantenimiento	6/6/2024	X	No se esta usando todavia
Incubadora (04)	Parte externa e interna	Revisión y ajuste de temperatura, Revisión y cambio de filtro bacteriológico, Verificación de alarmas, Calibración general Y Limpieza general.	Preventivo	Trimestrtal	12/12/2023	12/3/2024	X	Bueno en uso
Lampara cuello de ganzo (06)	Parte electrica y bombilla	Verificación de en la parte eléctrica y verificar las bombilla.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	4/12/2023	4/1/2024	X	Bueno en uso
Cuna de color radiante	Parte externa	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestrtal	4/12/2023	4/3/2024	X	Bueno en uso

Lampara de fototerapia (02)	Parte electrica	Verificacion de las lamparas, verificacion electrica, prueba de funcionamiento	Preventivo	Mensual	4/12/2023	4/1/2024	X	Bueno en uso
Lampara Quirurjica Movil (01)	Parte electrica y bacteria	Verificación de las lámparas, verificación eléctrica, prueba de bacteria y prueba de funcionamiento	Preventivo	Mensual	12/12/2023	12/1/2024	X	Bueno en uso
Lampara quirurjica dos satelites (02)	Parte electrica	Verificacion de las lamparas, verificacion electrica, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Mensual	12/12/2023	12/1/2024	X	Bueno en uso
Mesa de parto electrica (01)	Parte externa	Limpieza general, engrase, chequeo electrico y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	4/12/2023	4/6/2024	X	Bueno en uso
Mescladora de tubo (01)	parte externa y electrica	Mantenimiento eléctrico, engrase y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Bueno en uso
Lavadora industrial (01)	Parte interna y externa	Chequeo de conductos de agua, verificación de las correas, verificación de la parte electrica, limpieza general y prueba de funcionamiento	Preventivo/ Correctivo	Mensual	No se le ha dado mantenimiento		X	Aun no esta funcionando, se esta preparando la estrura para proceder a montarla
Microscopios en total 03 unidades	Parte externa	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento..	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Bueno en uso
Monitor de signos vitales (12)	Parte externa	Cheque de bacteria, chequeo de partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	Preventivo	Trimestral	12/12/2023	12/3/2024	X	Bueno en uso
Monitol fetal en total 02 unidades	Parte externa	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores	Preventivo	Trimestral	12/12/2023	12/3/2024	X	Bueno en uso
Nebulizador en total 05 unidades	Parte interna y externa	Limpieza del equipo, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones 0 ruido, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	1/12/2023	1/3/2024	X	Bueno en uso
Negatoscopio en total 15	lamparas, interruptores y cable	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Preventivo	Trimestral	13/12/2023	13/3/2024	X	Bueno en uso
Otoscopio	Limpieza general	Limpieza y desinfeccion, cambio de baterias.	preventivo	Trimestral	13/12/2023	13/3/2024	X	Bueno en uso

Unidad odontologica (01)	Parte externa e interna	Mantenimiento general, chequeo de fugas (agua aire), chequeo partes eléctricas, regulación y calibración de presión.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/6/2024	X	Bueno en uso
Rayos X dental (01)	Mantenimiento y limpieza	Chequeo eléctrico, limpieza general, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	5/12/2023	5/6/2024	X	Bueno en uso
Nevera de gas 01	Chequeo general	lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	Preventivo	Bimestral	13/12/2023	13/2/2024	X	Bueno en uso
Nevera en Total 06	Chequeo general	Matenimiento completo, verificar los cables y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	13/12/2023	13/2/2024	X	Bueno en uso
Sonografo en total 02	Parte Externa	Cheque de funcionamiento y limpieza.	Preventivo	Trimestral	13/12/2023	13/2/2024	X	Bueno en uso
Televisores en total 06	Parte externa	Chequeo de funcionamiento y limpieza.	Preventivo	Trimestral	13/12/2023	13/2/2024	X	Bueno en uso
Video colposcopio 01	Parte externa	Limpieza general y desinfección y cheque de partes eléctricas	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Bueno en uso
Infraestructura	Pintura, techos, muros, parqueos y sotea.	Mantenimieto de pintura donde sea necesario, matenimiento en la sotea, señalizacion de los parqueos, aceras y contenes, red electrica etc	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	10/12/2023	10/3/2024	X	En el mantenimiento a la infraestructura se recontruyo las aceras y contenes, se le dio mantenimiento al techo y estamos a la espera de la disponibilidad del pintor, para pintar.
Pisos generales	Pisos de marmol, piso de ceramica y terraza.	Mantenimiento general, y correccion si hay fallas	Preventivo/ Correctivo	Diario	Diario		X	Bueno en uso
Equipos de lavanderia	Desagues, lavadora y secadora	Mantenime de los conductos de agua, chuequeo de las partes electgricas y pruva de funcionamiento.	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	18/12/2023	18/3/2024		se esta remodelando el area para instalar una secadora y una lavadora nueva
Moviliario oficinas y consultorios	Escritorios, Sillones, Bancos, Archivo y Estanteria	Apriete de tornillos y ajuste.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	5/12/2023	5/1/2024	X	Este tipo de mantenimiento tenemos que ejecutalo a diario, ya que siempre los equipos de oficina requieren de una supervision continua
Malla perimetral	Parte interna y externa	Limpieza, poda de arboles y reparacion	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	1/12/2023	1/3/2024	X	Se procedio a limpiar todas las maleas que le cubre, pero la misma se encuentra en mal estado.
Cisterna	Parte interna	Lavado, desinfeccion y clorificacion	Preventivo/ Correctivo	Sermestral	30/11/2023	30/3/2024	X	
Control de plagas	Parte interna e externa	Desinfeccion en general y fumigacion	Preventivo/ Correctivo	Sermestral	2/12/2023	2/6/2024	X	Por motivo al dengue nod vo,od en ls obligacion de adelantar el preceso.
Jardineria	Arboles, jardines frontal y later	poda de arboles, poda de los jardines y fumigacion.	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	1/12/2023	1/3/2024	X	todo en orden
Red electrica	Cuartos electricos, UPS Industrial, Toma corrietes, Lamparas de iluminacion, Tubos fluorescentes, Bombillos Interruptores y breaker.	Verificacion de todas las lamparas y bombillas, y reemplazarlo si alguna se encuentra dañada, verificacion de todos los toma corrientes e interruptores, verificacion de los Breaker, cheque de funcionamiento del UPS, verificacion de las bacterias del UPS.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	11/12/2023	11/12/2024	X	En este mes se le dio mantenimiento genertal.

Planta electrica	Al motor, Bateria, al radiador Motor de arranque.	Mantenimiento general, cambio de aceite, cambio de filtros aire, aceite y gasoil, chequeo de la bateria, verificacion del motor de arranque, verificacion del culan del radiador.	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	20/12/2023	20/3/2024	X	en este mes se le dio mantenimiento general
------------------	--	---	------------------------	------------	------------	-----------	---	---