



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 1/06/2024

Ficha No: 1

Datos del Equipo

Nombre: Lampara de luz ultra violeta
 Marca: _____ Modelo: _____
 Serie: _____
 Ubicación: _____ Inventario No. _____
 Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas: Se muere lampara de reemplazo para el bloque II de estopero

Descripción de Acciones

Inspección Física
 Revisión Operacional
 Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Lo que estaba en ese mismo bloque se lleva a electro medicina por tener control

Materiales Utilizados

Condición Final

Antonio Alegre
Nombre del Electromédico

Gilberto L. (apellidos)
Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 26/05/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Auto, Clase de Vapor

Marca: Consolidate Modelo: _____

Serie: 6832E

Ubicación: _____ Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas: Se le cambio la Válvula Solenoide del escape

Descripción de Acciones

Inspección Física
Revisión Operacional
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Condición Final

Cristian A. León
Nombre del Electromédico

Jean Carlos Rojas
Encargado de Área

3689

REPORTE DE SERVICIOS

Cliente: Hospital Traumatología Dr. Nex Arias Fecha: 8/16/24
Lora.

FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS	ESTADO DEL SISTEMA
8/16/24	9:40am	11:40am	2 HRS	OK

MODALIDAD	Sonografía
MARCA	Mindray
MODELO	250
SERIE	HH6-2C003407

SERVICIOS:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMÁGENES MÉDICAS | <input type="checkbox"/> ENTRENAMIENTO |
| <input type="checkbox"/> REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CARDIOLOGIA | <input type="checkbox"/> MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS |
| <input type="checkbox"/> DIAGNÓSTICO | <input type="checkbox"/> ADECUACIÓN DE ÁREA MEDICA |
| <input type="checkbox"/> INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS EN GENERAL | <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS |
| <input type="checkbox"/> EVALUACIÓN | <input type="checkbox"/> REPARACIÓN DE TRANSDUCTORES |
| <input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTOS A EQUIPOS MÉDICOS | <input type="checkbox"/> REPARACIÓN DE ENDOSCOPIOS |

SÍNTOMAS REPORTADOS O TRABAJO SOLICITADO:

* Mantenimiento preventivo

DIAGNÓSTICO Y TRABAJO REALIZADO:

* se realizó chequeo al software del equipo.
 * se realizó limpieza interna y externa del equipo.
 * se realizó limpieza de transductores.

COMENTARIOS:

* El equipo queda funcionando.

EQUIPAMIENTO MÉDICO EN GENERAL: Venta, Instalación, Mantenimiento, Reparación, Suministro de Utensilios, Material Gastable y Adecuación de Áreas.

INGENIERIA CIVIL: Diseño, Presupuestos y Construcción de Obras Civiles.

Aceptado por: [Signature]

Ingeniero de Servicio: FURIS R.

Fecha: 8/16/2024

Correo: _____

3688

REPORTE DE SERVICIOS

Cliente: Hospital traumatologico Dr. Ney Arias L

Fecha: 8/6/2024

FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS	ESTADO DEL SISTEMA
8/6/2024	10:00 am	12:00 pm	2 Hrs	OK

MODALIDAD	Arco en C
MARCA	PHILIPS
MODELO	BV Pulsora
SERIE	000543

SERVICIOS:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMÁGENES MÉDICAS | <input type="checkbox"/> ENTRENAMIENTO |
| <input type="checkbox"/> REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CARDIOLOGÍA | <input type="checkbox"/> MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS |
| <input type="checkbox"/> DIAGNÓSTICO | <input type="checkbox"/> ADECUACIÓN DE ÁREA MÉDICA |
| <input type="checkbox"/> INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS EN GENERAL | <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS |
| <input type="checkbox"/> EVALUACIÓN | <input type="checkbox"/> REPARACIÓN DE TRANSDUCTORES |
| <input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTOS A EQUIPOS MÉDICOS | <input type="checkbox"/> REPARACIÓN DE ENDOSCOPIOS |

SÍNTOMAS REPORTADOS O TRABAJO SOLICITADO:

* Mantenimiento preventivo

DIAGNÓSTICO Y TRABAJO REALIZADO:

- * Chequeo completo del equipo (estado físico y funcionamiento)
- * Desmonte de las taras y limpieza de componentes internos.
- * Ajuste de conexiones internas del equipo.
- * Limpieza general y profunda del equipo.

COMENTARIOS:

- * el equipo quedó en funcionamiento
- El equipo solo trabaja en manual, no utilizar el modo automático.

EQUIPAMIENTO MÉDICO EN GENERAL: Venta, Instalación, Mantenimiento, Reparación, Suministro de Utensilios, Material Gastable y Adecuación de Áreas.

INGENIERIA CIVIL: Diseño, Presupuestos y Construcción de Obras Civiles.

Aceptado por: [Signature]

Ingeniero de Servicio: [Signature]

Fecha: 8/06/2024

Correo: _____

3686

REPORTE DE SERVICIOS

Cliente: Instituto Traumatológico Dr. Rey Arisbon Fecha: 8/6/24

FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS	ESTADO DEL SISTEMA
8/6/24	10:00	12:00	2h	OK

MODALIDAD	Prazo em C
MARCA	Genotay
MODELO	Zen 9000
SERIE	Gen-072601-10618

SERVICIOS:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMÁGENES MÉDICAS | <input type="checkbox"/> ENTRENAMIENTO |
| <input type="checkbox"/> REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CARDIOLOGÍA | <input type="checkbox"/> MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS |
| <input type="checkbox"/> DIAGNÓSTICO | <input type="checkbox"/> ADECUACIÓN DE ÁREA MÉDICA |
| <input type="checkbox"/> INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS EN GENERAL | <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS |
| <input type="checkbox"/> EVALUACIÓN | <input type="checkbox"/> REPARACIÓN DE TRANSDUCTORES |
| <input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTOS A EQUIPOS MÉDICOS | <input type="checkbox"/> REPARACIÓN DE ENDOSCOPIOS |

SÍNTOMAS REPORTADOS O TRABAJO SOLICITADO:

Mantenimiento preventivo

DIAGNÓSTICO Y TRABAJO REALIZADO:

Limpieza interna y externa al equipo.
Limpieza de filtros y ventiladores.
Substitución de partes mecánicas.
Pruebas de funcionamiento.

COMENTARIOS:

Equipo totalmente funcional.

EQUIPAMIENTO MÉDICO EN GENERAL: Venta, Instalación, Mantenimiento, Reparación, Suministro de Utensilios, Material Gastable y Adecuación de Áreas.

INGENIERIA CIVIL: Diseño, Presupuestos y Construcción de Obras Civiles.

Aceptado por: [Signature]

Ingeniero de Servicio: Jorge de Castro

Fecha: 8/06/2024

Correo: _____



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 23/06/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Auto Clase de Repara
 Marca: Chincha Modelo: XGL.HWDD-0.3
 Serie: XGL.HWDD-0.32006005
 Ubicación: _____ Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas: Se limpió ambos conos selladores de los puertos
travesero y delantero. Se cambió el bulbo neumático
que abre el puerto delantero.

Descripción de Acciones

Inspección Física
 Revisión Operacional
 Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Hay que cambiar la solenoide neumática de otro
y abrir puerto travesero, Cambiar bulbo neumático
de abrir puerto delantero.

Materiales Utilizados

Condición Final

✓ ×

Christian A. Lopez
Nombre del Electromédico

Juan Carlos Flores
Encargado de Area



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 26/05/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Auto Clavo de Vapor

Marca: Consuldatec Modelo: _____

Serie: N/A Inventario No. _____

Ubicación: _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas: Se le hizo la salinación del escape

Descripción de Acciones

Inspección Física
Revisión Operacional
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Condición Final

Liztari A. Lege
Nombre del Electromédico

Jean Carlos Rojas
Encargado de Área

 ESTERILIZADOR
DE VAPOR





21/06/2024 16:05





21/06/2024 16:05



21/06/2024 18:21












21/06/2024 18:17

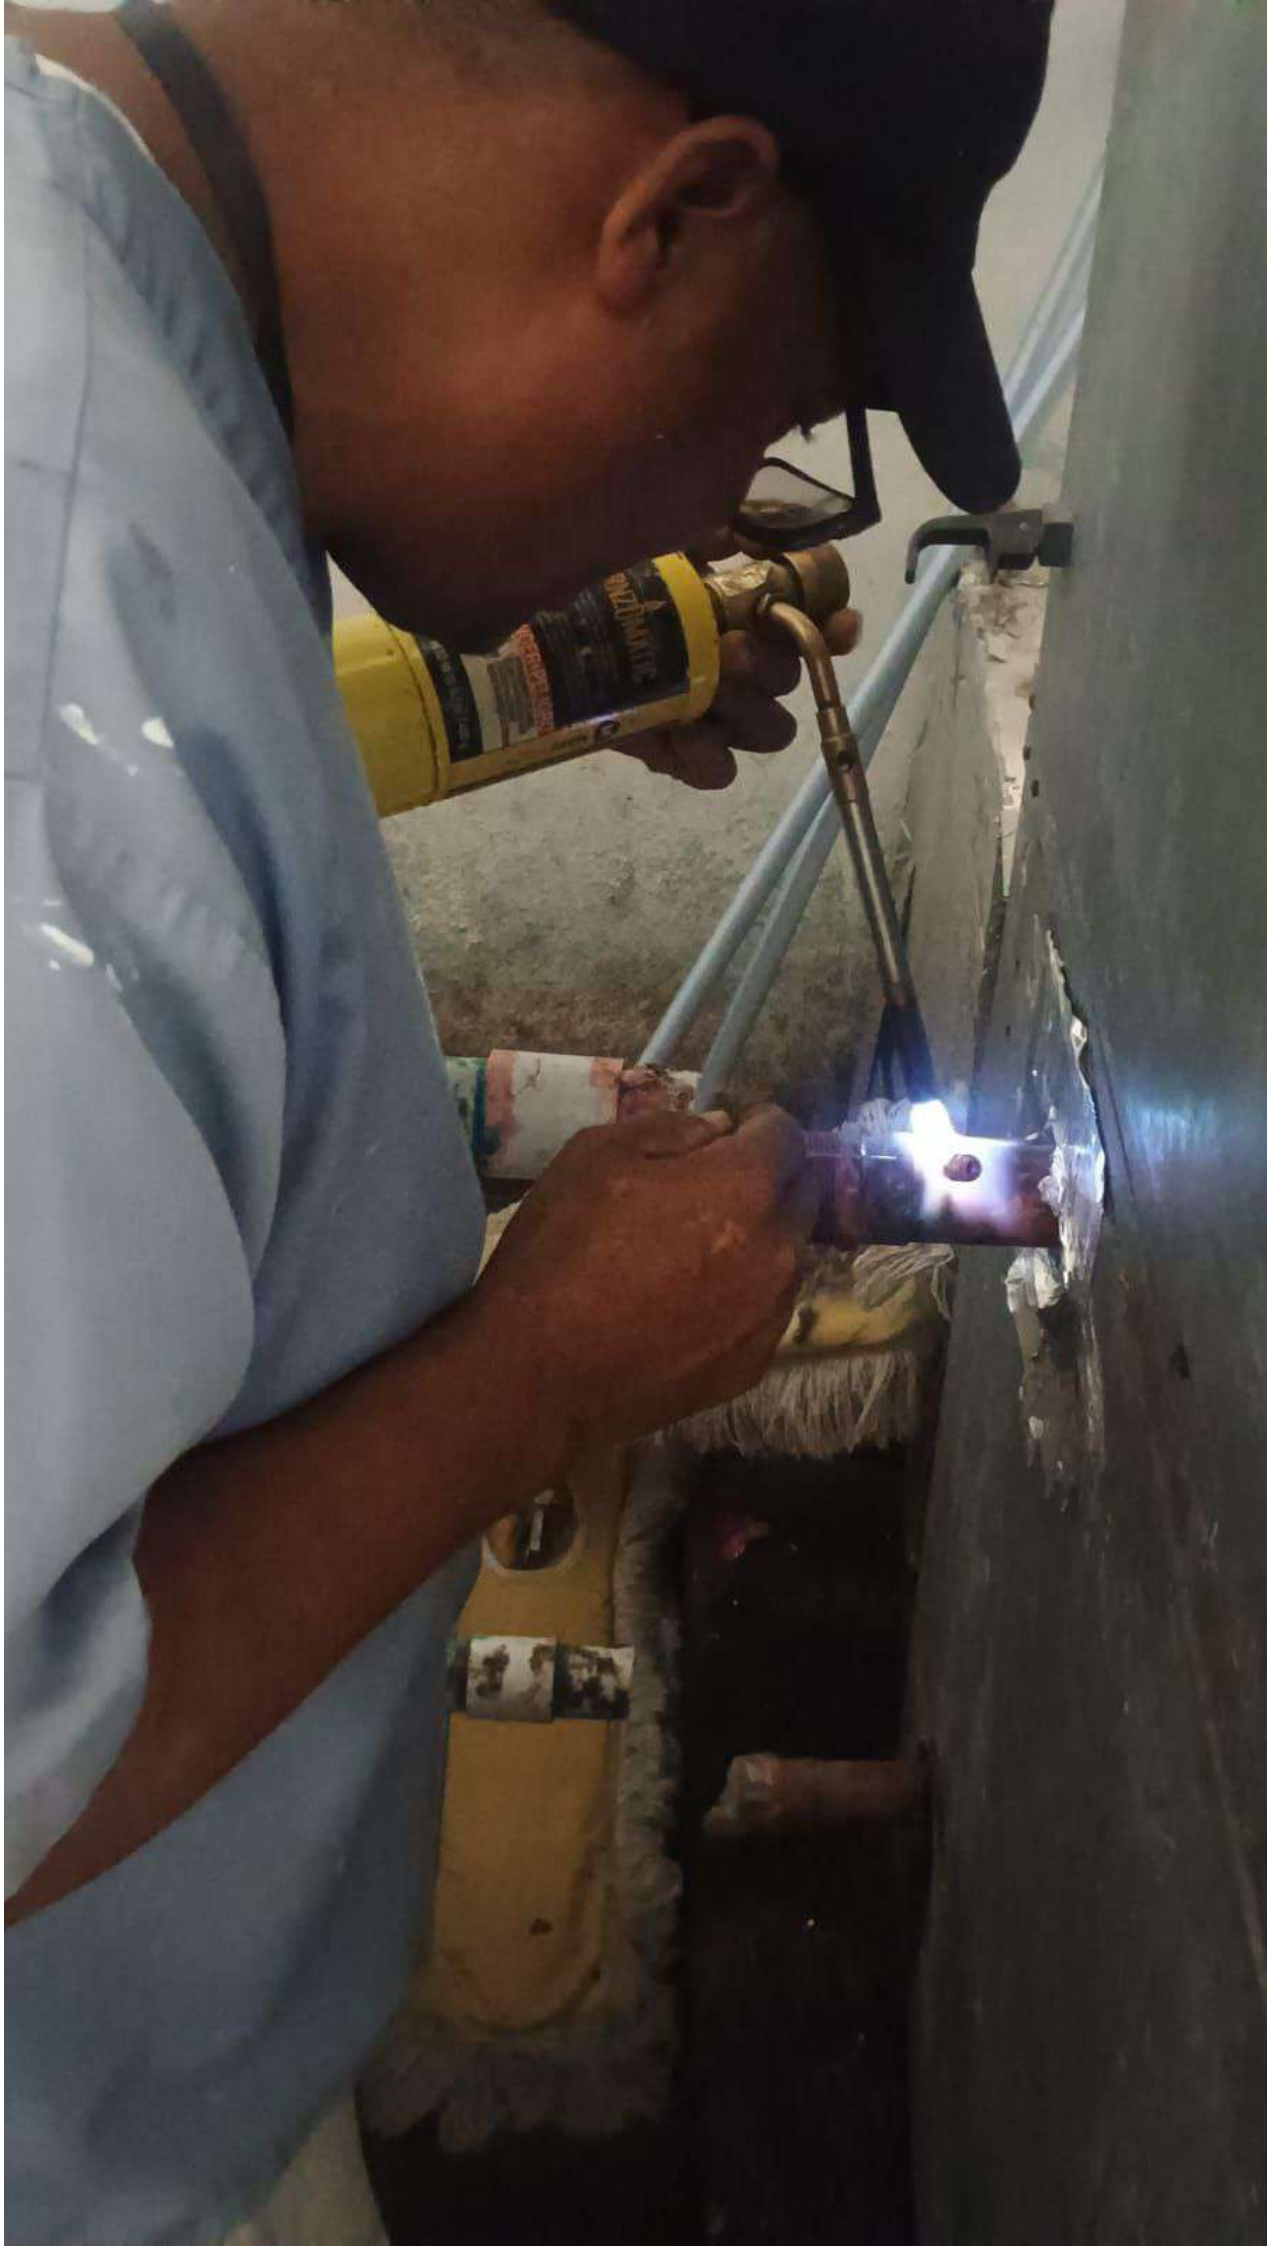











Ejecutando 2024/6/23 16:13:46

Cámara de Presión: -96 kPa
Cámara de Temperatura: 77.5 °C

Medidor Estr

Atención

¿El ciclo de esterilización se ha completado!
¿Quieres abrir la puerta? 13

OK Cancelar

Tejido Fase: Terminado

41


Puerta Historia Ayuda Apagar Inicio Atrás





Te lavaste
las MANOS?

Entr.

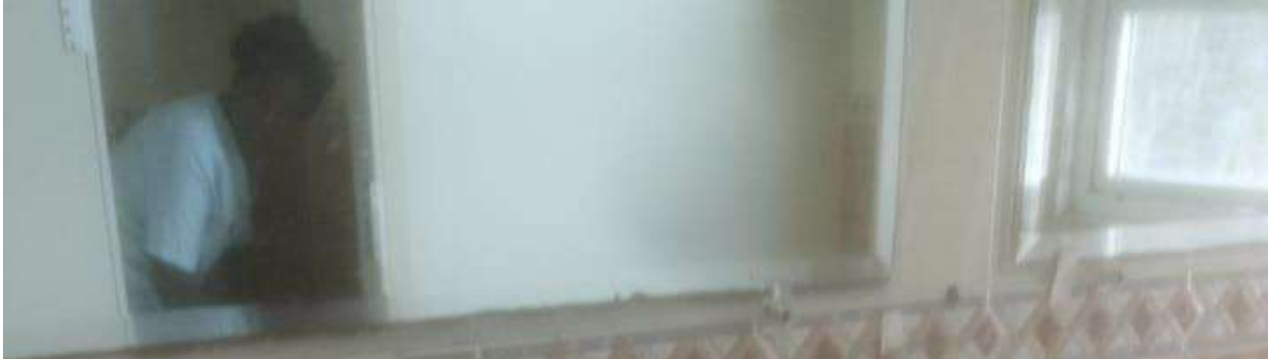





11/06/2024 19:33







11/06/2024 20:55





 **RECLEAR IMPORT SRL**
TANQUE DE SAL
Tel.: 829-898-0978 • Email: reclearimport srl@gmail.com



14/06/2024 20:36














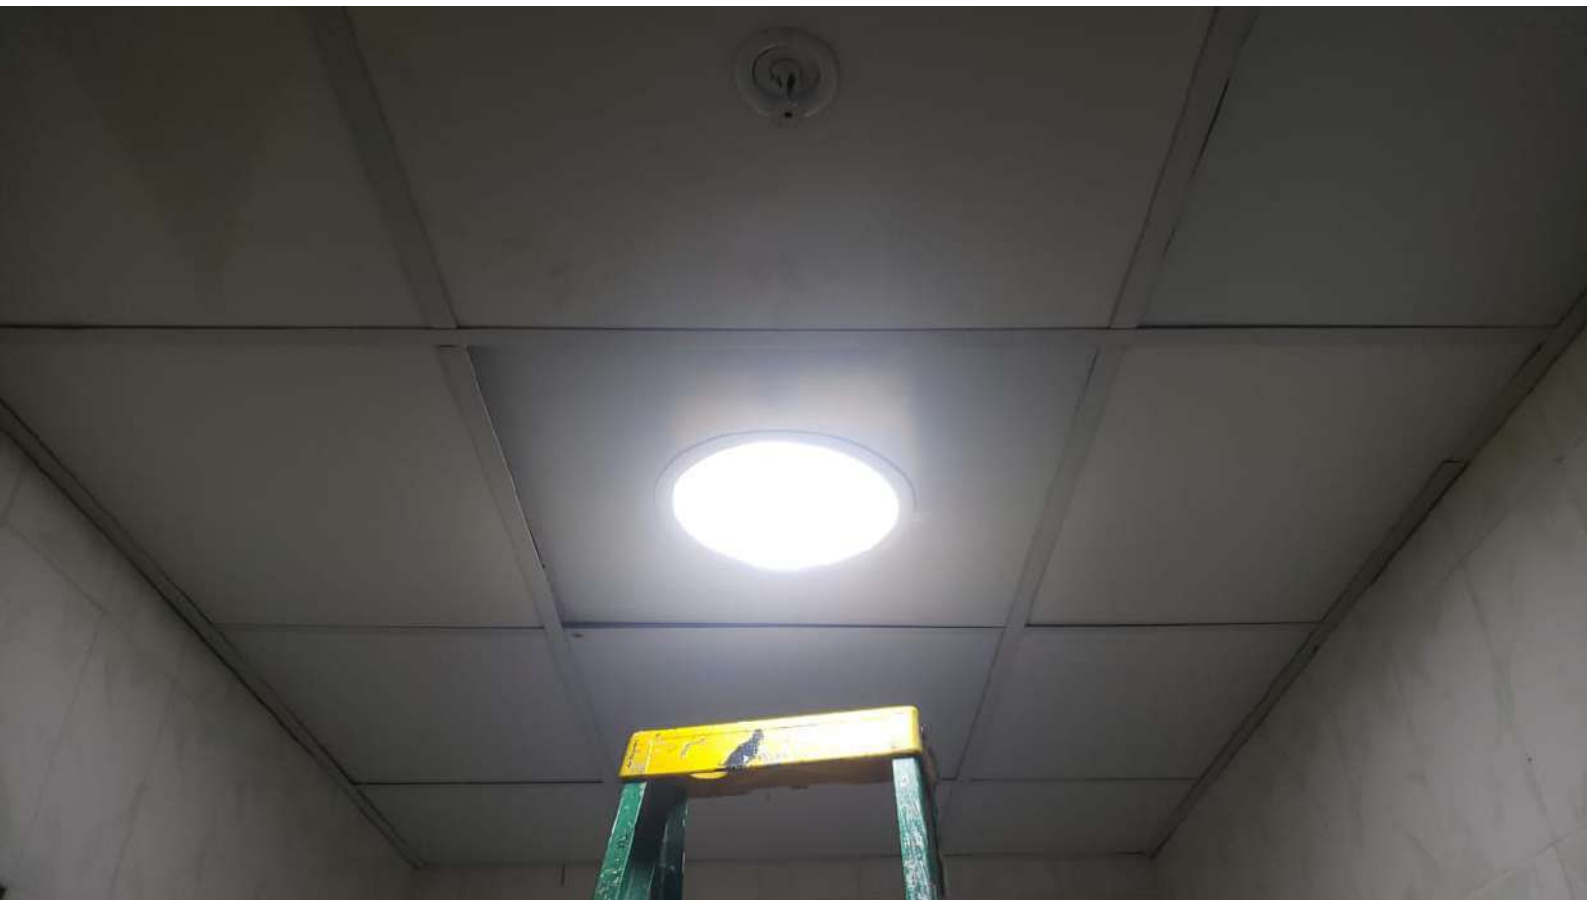




18/06/2024 19:57



19/06/2024 17:02






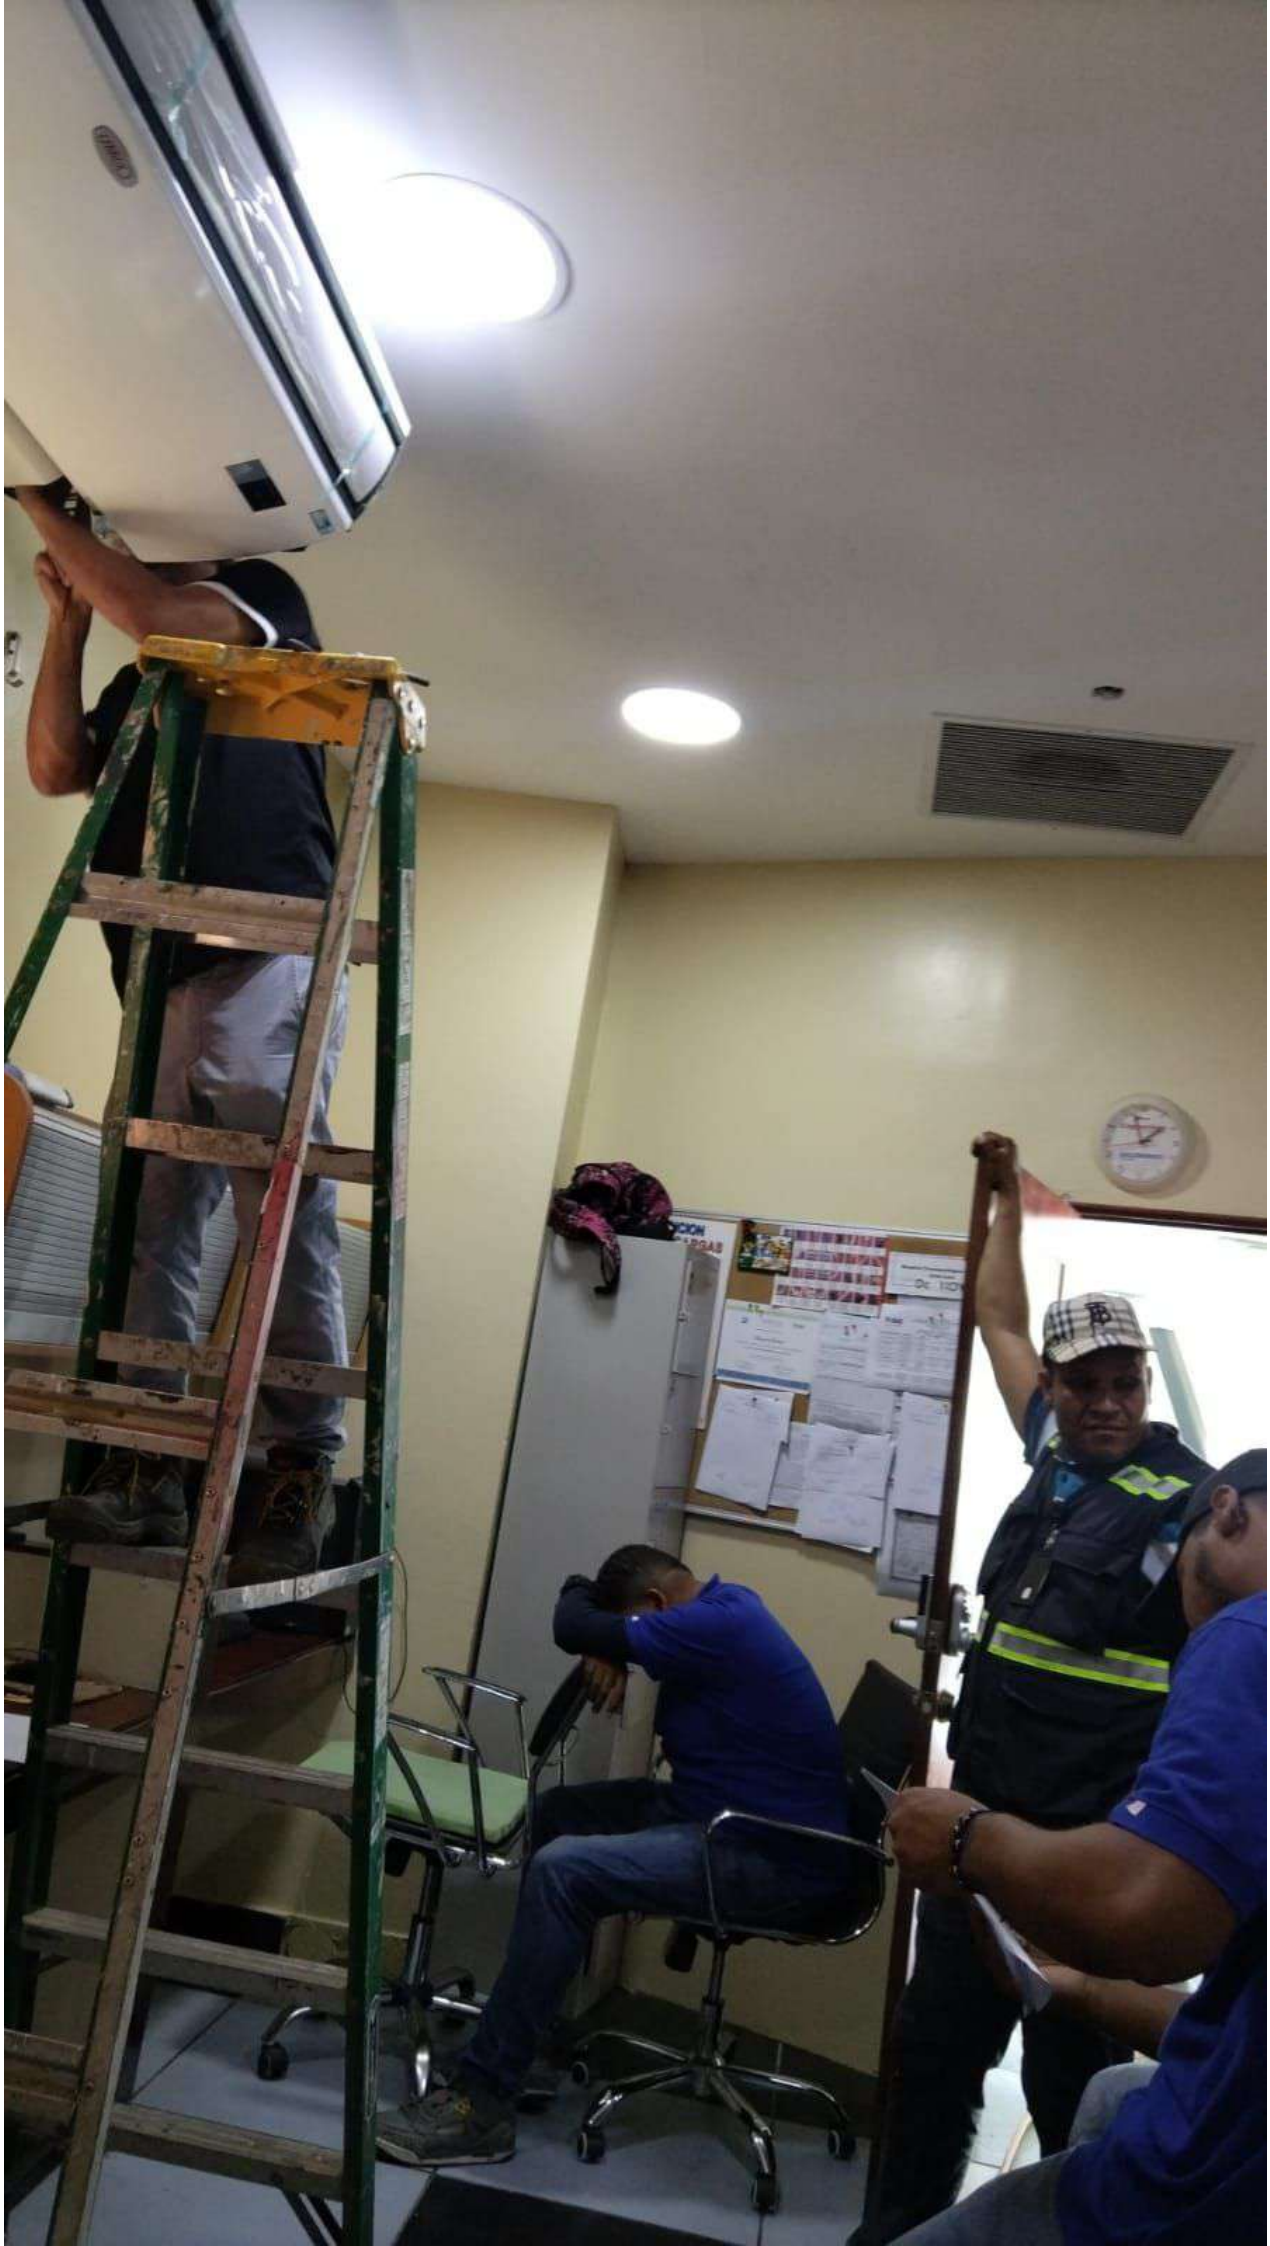







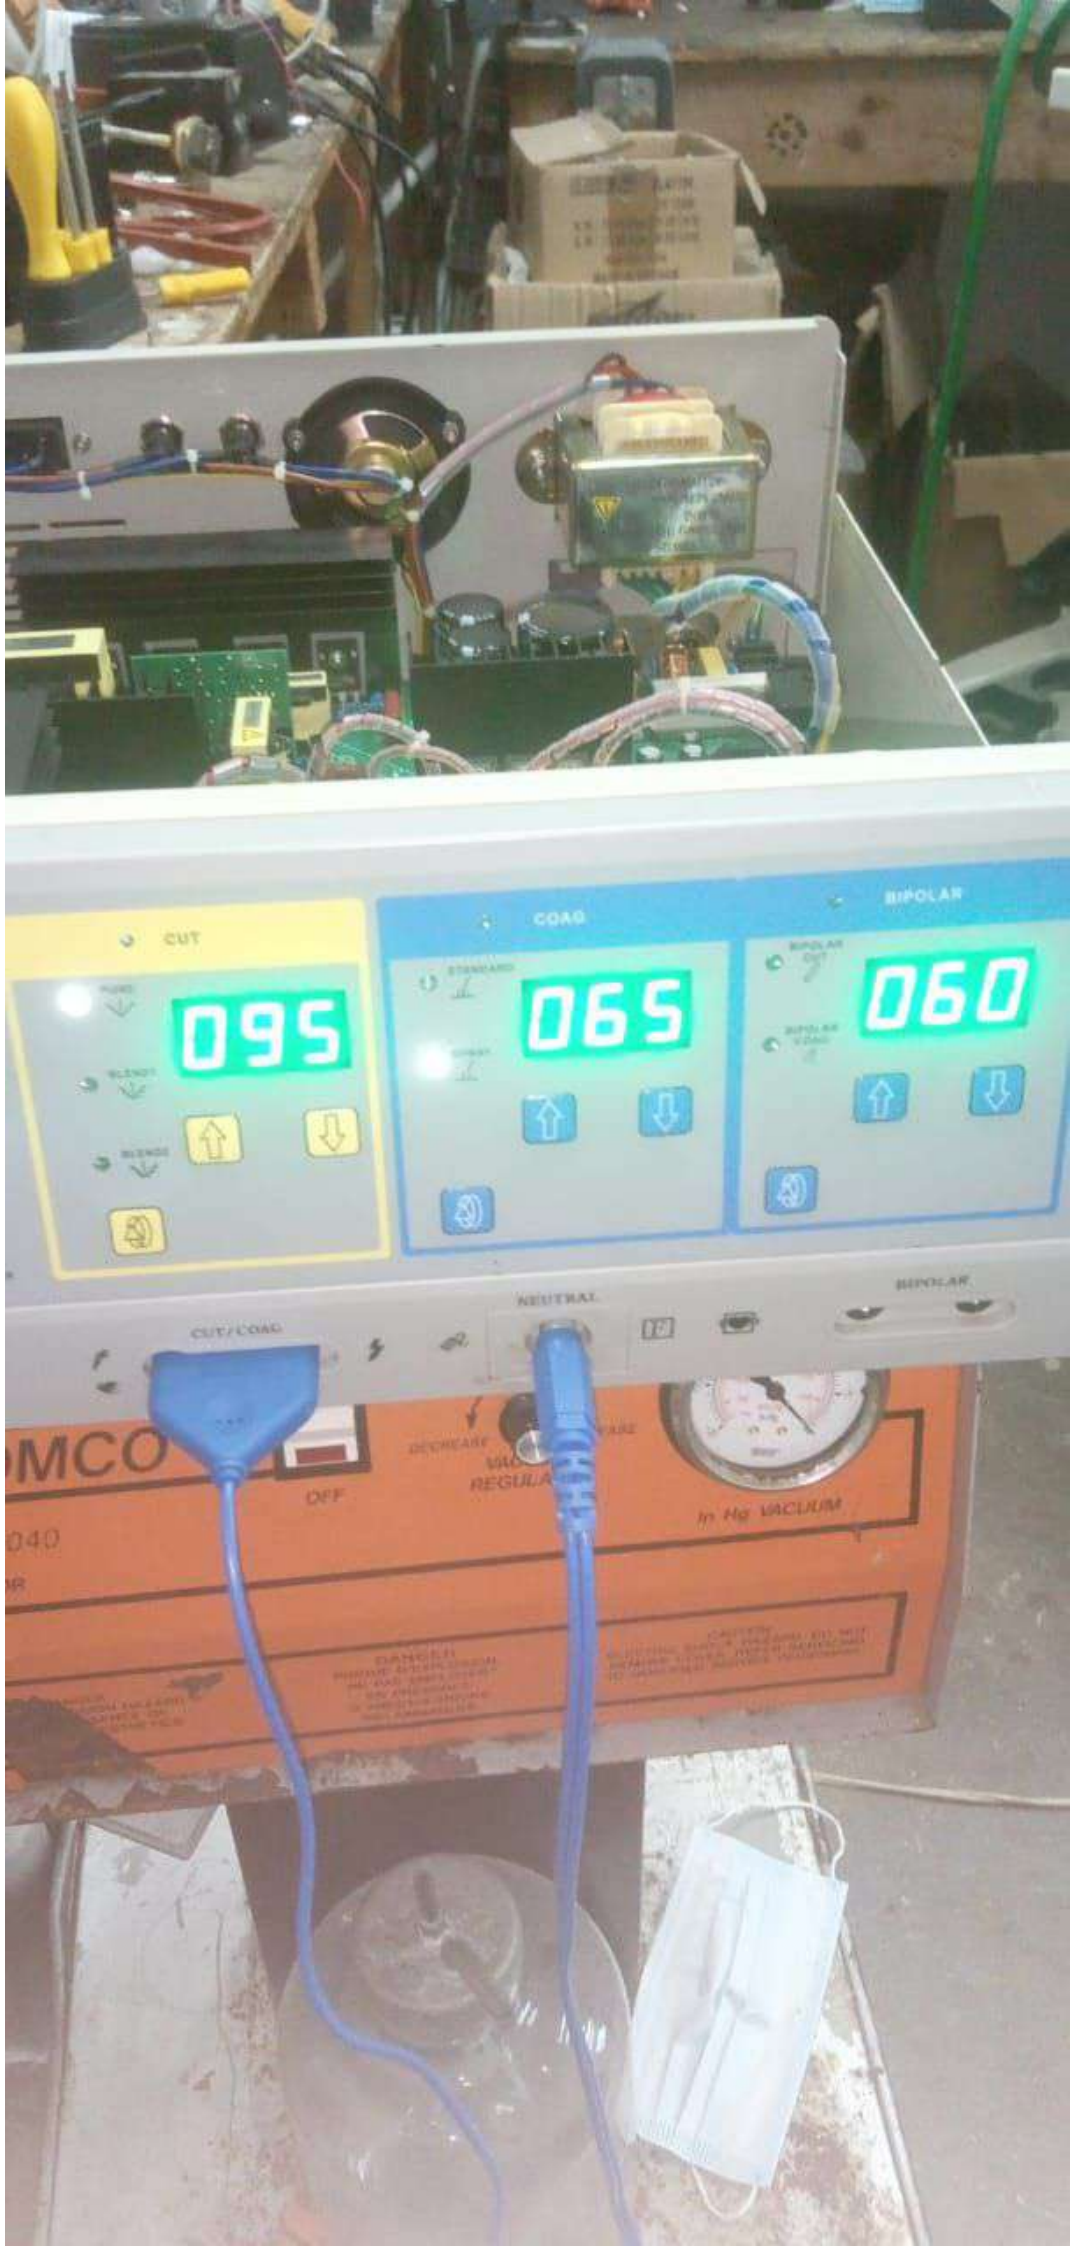

CUT

095

COAG

065

BIPOLAR

060

MCO

040

MR

NEUTRAL

BIPOLAR

DECREASE

VACUUM

REGULATOR

In Hg VACUUM

CAREFULLY

WARNING: ALWAYS USE WITH
THE APPROPRIATE ELECTRODES
AND ALWAYS WEAR EYE PROTECTION
AND GLOVES.

CAUTION
DO NOT TOUCH THE HOT SURFACE OF THE UNIT
OR THE ELECTRODES WHEN IN USE.
DO NOT TOUCH THE ELECTRODES WHEN
THE UNIT IS ON.







 ESTERILIZADOR
DE VAPOR











27/06/2024 16:59

