




Reparación de aire de vacuna





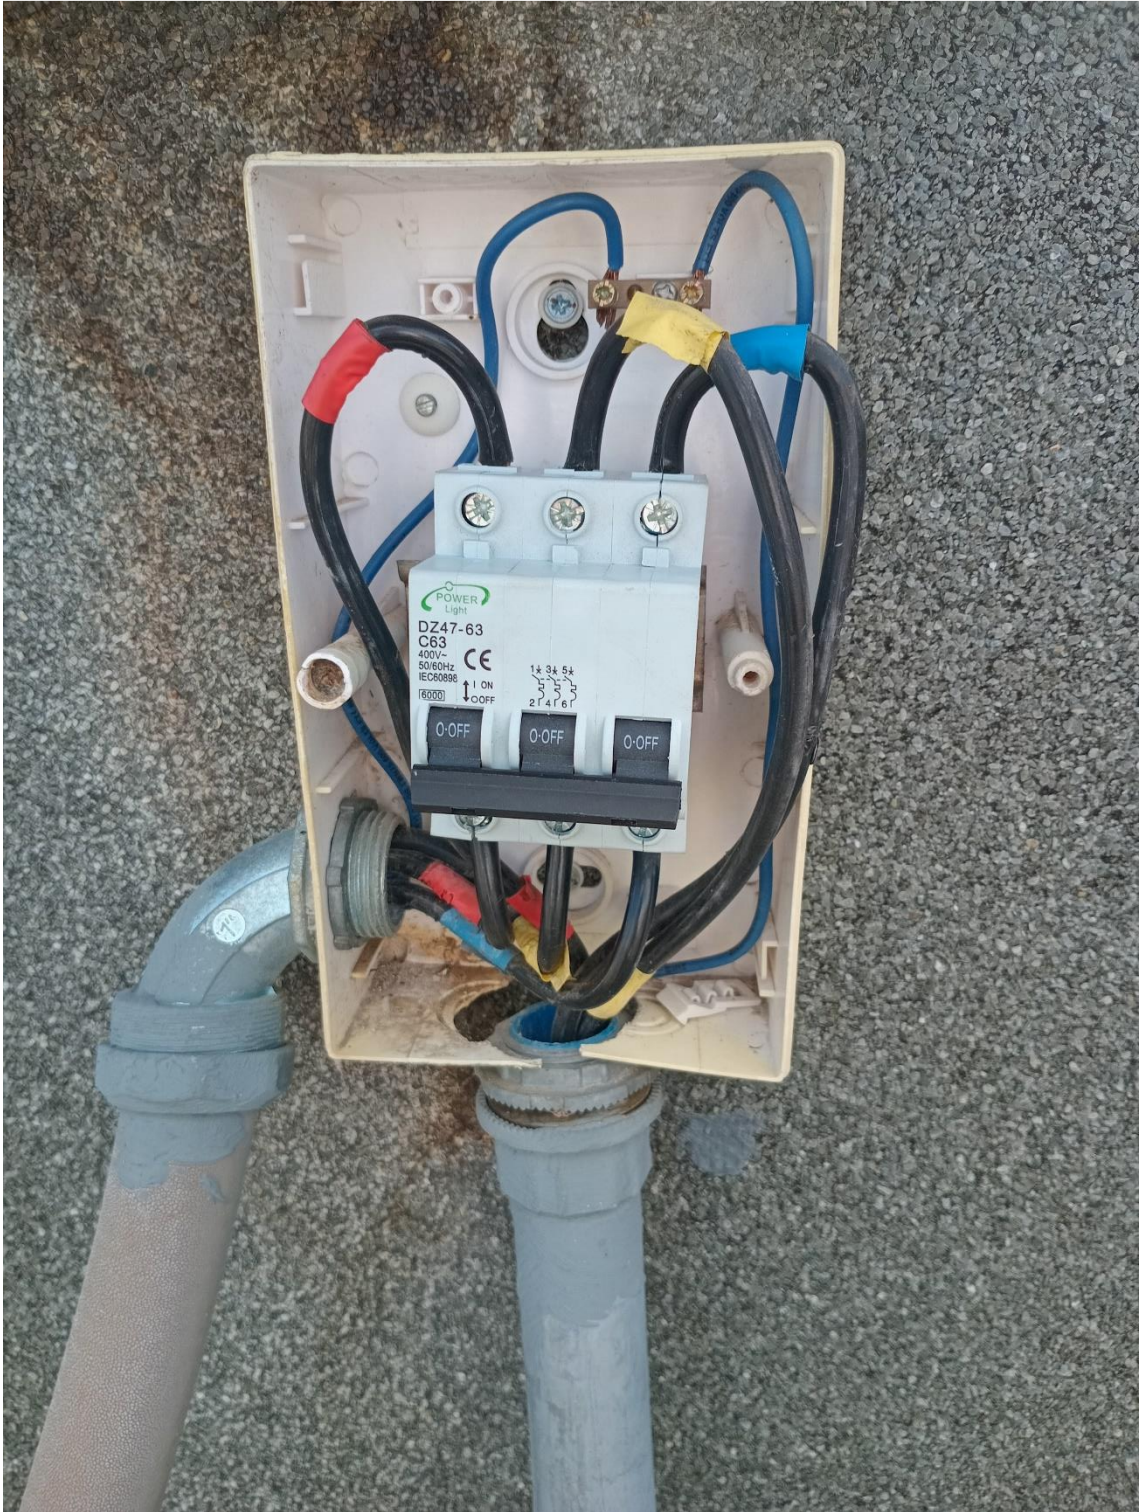

Verificación de sensores de agua Rojo alto, blanco medio y negro bajo, El negro va con la varilla más larga, el blanco la media y el rojo la más corta. Mantenimiento Preventivo (09/07/2024).





Fuga de oxígeno en la máquina de anestesia 2/7/2024

