

Mantenimiento preventivo rotador VDRL

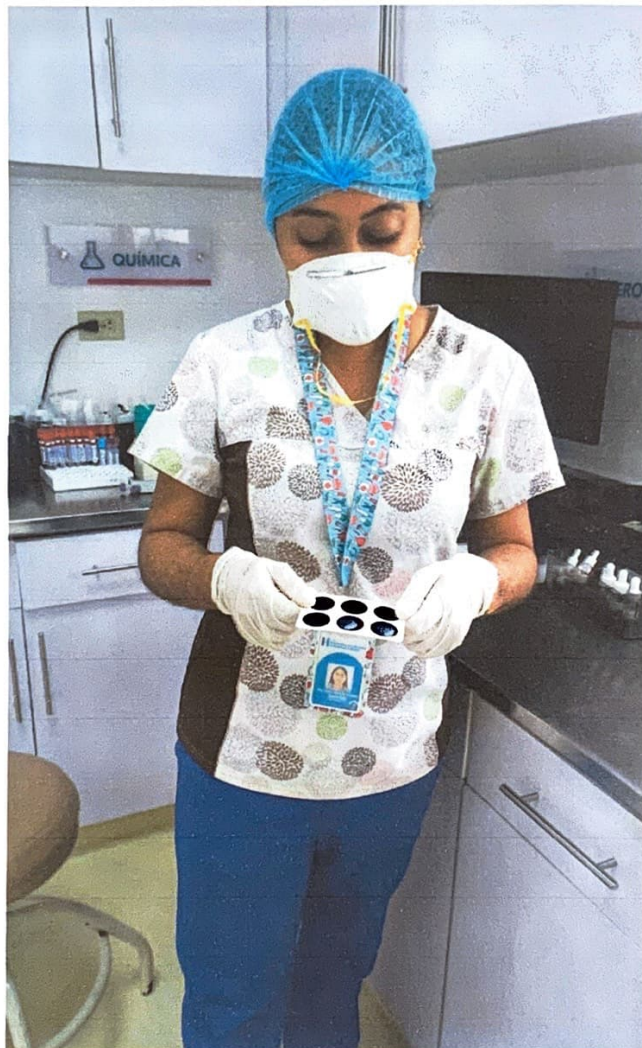


Foto tomada 11-3-2025



Mantenimiento preventivo equipo de química

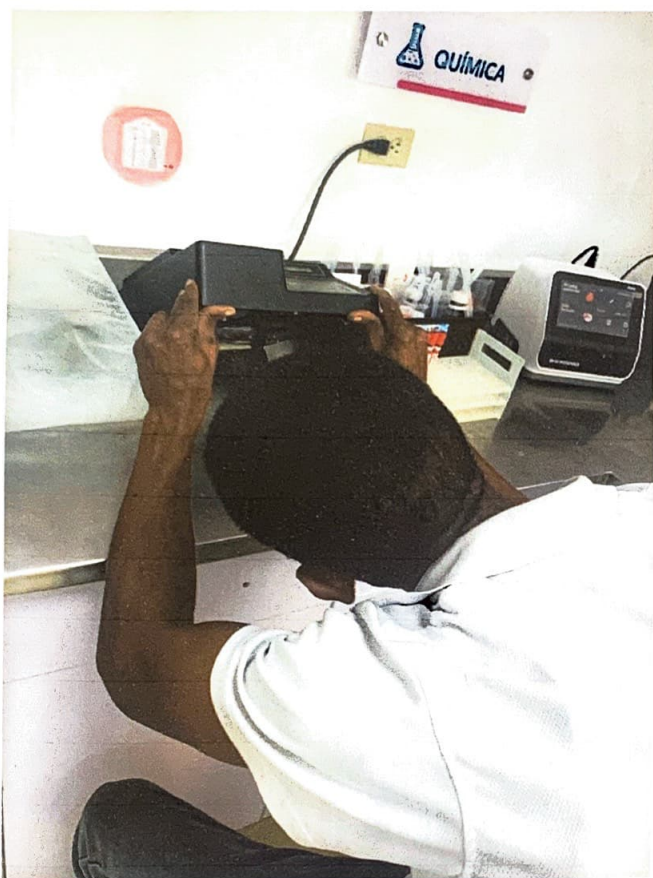


Foto tomada 11-3-2025



Mantenimiento preventivo pipetas automáticas



Foto tomada 11-3-2025



Mantenimiento preventivo monitores

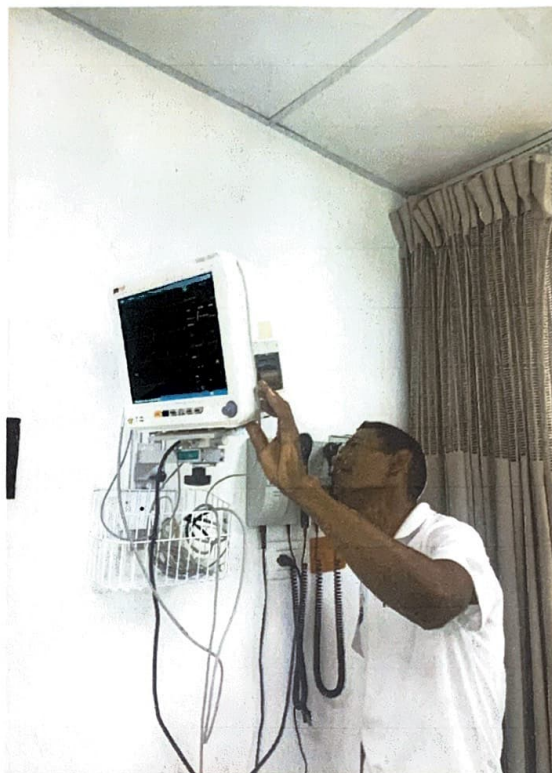


Foto tomada 14-3-2025



Mantenimiento preventivo electrocardiograma

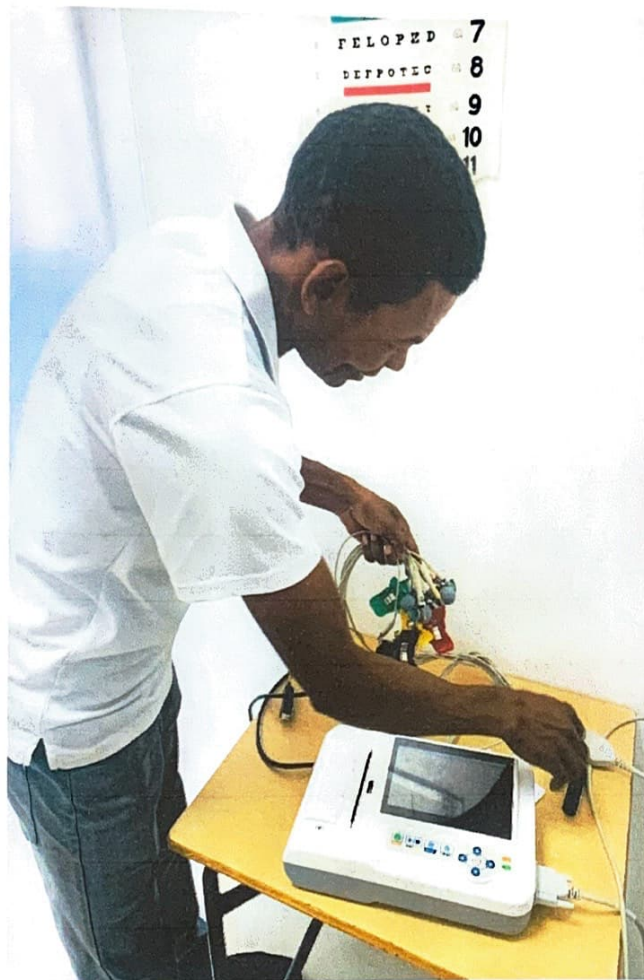


Foto tomada 14-3-2025



Mantenimiento preventivo laringoscopio

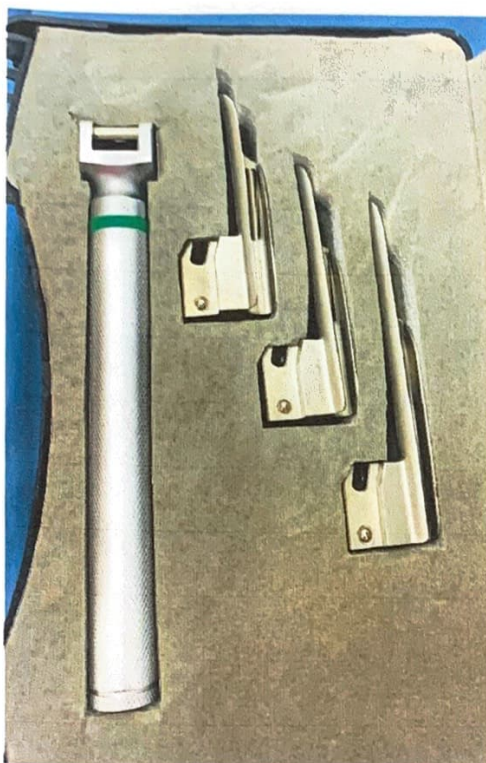


Foto tomada 7-3-2025



Mantenimiento preventivo glucómetro

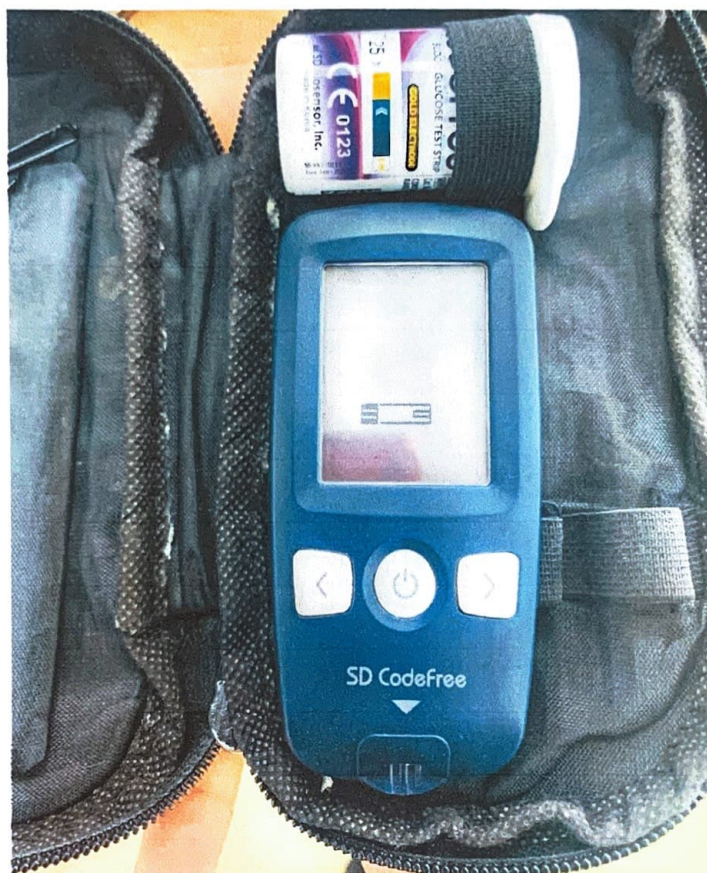


Foto tomada 11-3-2025



Mantenimiento preventivo cauterio

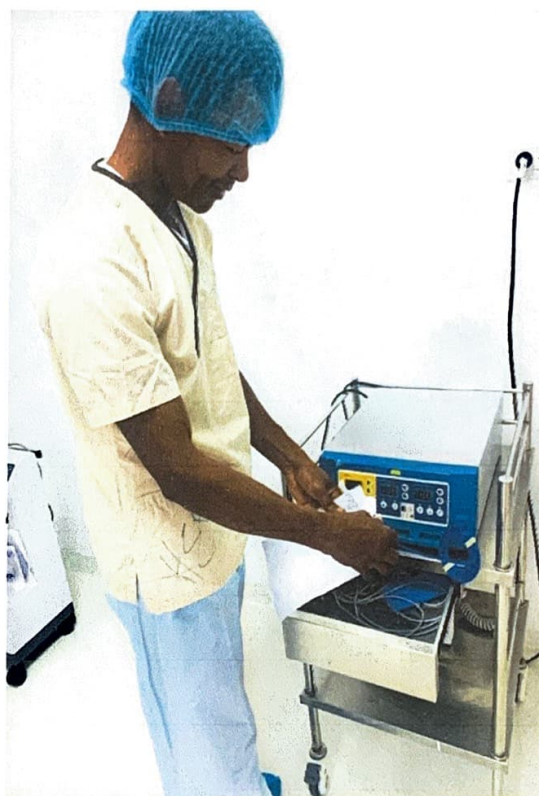


Foto tomada 7-3-2025



Mantenimiento preventivo mesa de cirugía



Foto tomada 7-3-2025



Mantenimiento preventivo sonógrafo



Foto tomada 14-3-2025



Mantenimiento preventivo planta eléctrica



Foto tomada 14-3-2025



Mantenimiento preventivo sillas

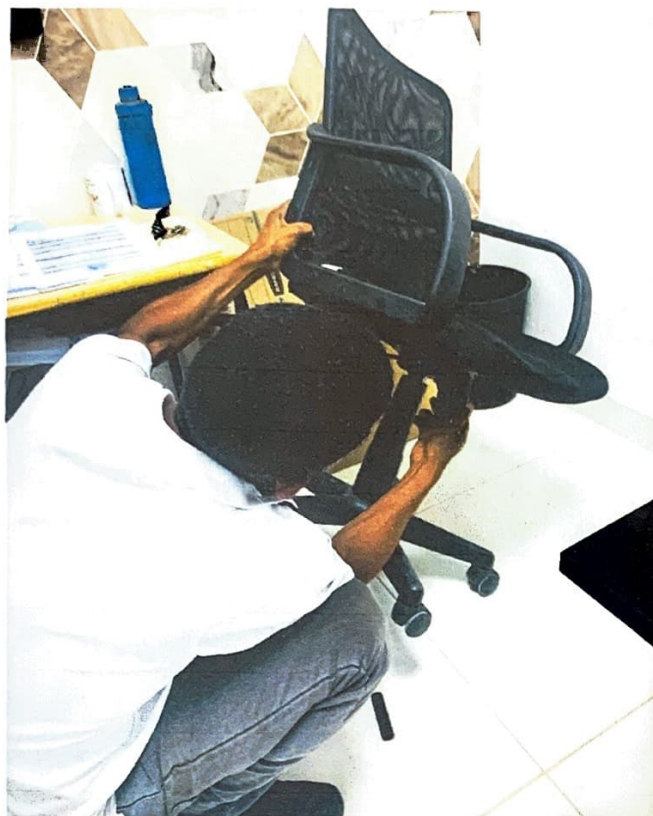


Foto tomada 14-3-2025



Mantenimiento preventivo puertas y ventanas



Foto tomada 14-3-2025



Mantenimiento preventivo manubrios, enchufes y conectores



Foto tomada 14-3-2025



Mantenimiento preventivo lavador y secadora



Foto tomada 14-3-2025



Mantenimiento preventivo gabinetes



Foto tomada 18-3-2025



Mantenimiento preventivo extractor de grasa


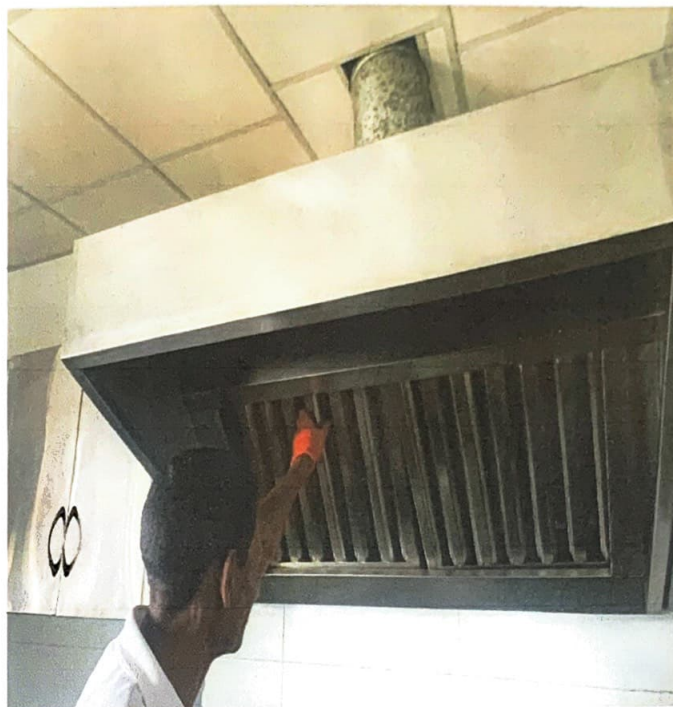


Foto tomada 18-3-2025

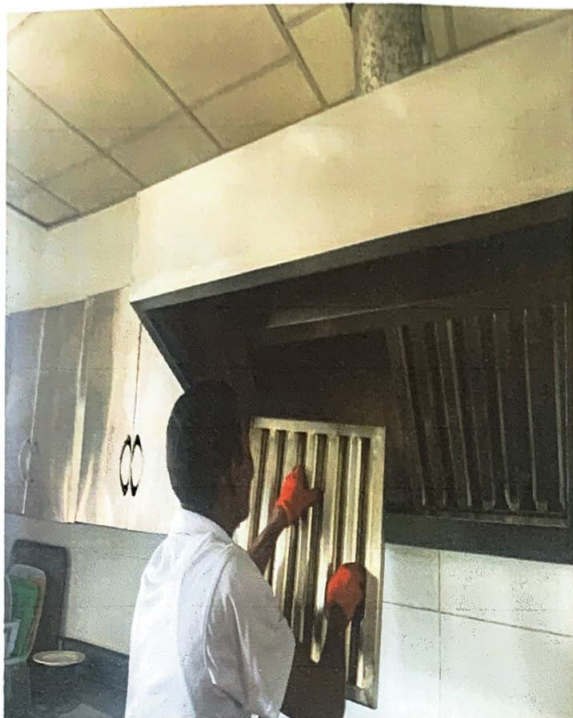

Mantenimiento preventivo Cámaras de seguridad



Foto tomada 18-3-2025



Mantenimiento preventivo limpieza exterior del centro



Foto tomada 18-3-2025



Mantenimiento preventivo colposcopio



Foto tomada 19-3-2025



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 14/3/25 Departamento: Calidad gestión

Tipo de equipo negatoscopio NO. INVENTARIO _____

Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☒	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☐	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



*En perpetua
cordicorng
Bartelo de la cruz*

FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 4/3/85 Departamento: Mantenimiento

Tipo de equipo verificación NO. INVENTARIO de la parte posterior del centro

Servicio Solicitado Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo

☐

Urgente

☐

Mantenimiento Preventivo

☒

Puede esperar hasta 24 horas

☐

Chequeo

☐

Puede esperar más de 48 horas

☐

Reparación

☐

Movilización

☐

Adecuado
Bartolo de la cruz



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 2/3/25 Departamento: Mantenimiento

Tipo de equipo nebulizadores NO. INVENTARIO _____

Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☒	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☐	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



En perfectas
condiciones

Batolo de la cruz



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 2/3/15 Departamento: Calidad

Tipo de equipo Aline acorde NO. INVENTARIO Corrado Centrole

Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☒	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☐	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☒	Movilización	☐



Partido @Acruz
los de emergencias
y oficinas administrativas
en reparación por
fuerza de trabajo

FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 2/3/25 Departamento: Mantenimiento

Tipo de equipo aire acondicionado NO. INVENTARIO redospleet

Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☒	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☐	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



*Botolo de la cruz
en perfectas condiciones*